Тепловое испытание светильника Glerio Universal 01S-25D-4K

Содержание

IR_00825.IS2 2

IR_00826.IS2 3

IR_00827.IS2 4

Отчет о проверке

Имя файла	IR_00825.IS2	Дата и время проверки	14.09.2019
Имя файла	IR_00826.IS2	Дата и время проверки	14.09.2019
Имя файла	IR_00827.IS2	Дата и время проверки	14.09.2019

Испытания светильника на консольном креплении

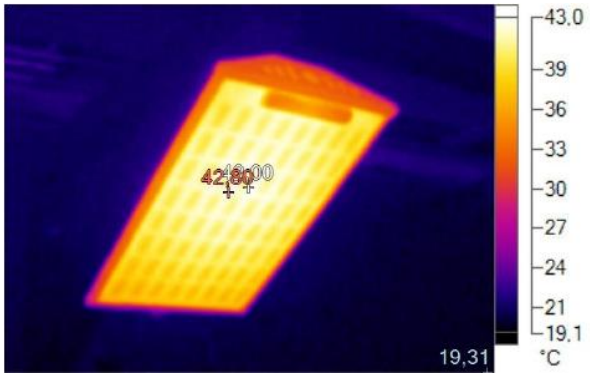

IR_00825.IS2
14.09.2019 16:21:43

Изображение в видимом свете

Информация об изображении

Температура фона	24,00°C
Коэффициент излучения	0,95
Передача	1,00
Средняя температура	25,05°C
Границы изображения	19,31°C до 42,80°C
Модель камеры	TiS45
Размер ИК-датчика	160 x 120
Серийный номер камеры	TiS45-17010391
Версия DSP	3.10.16
Версия OCA	3.10.16
Производитель камеры	Fluke Thermography
Время изображения	14.09.2019 16:21:43
Местонахождение файла	E:\ Новая папка\ IR_00825.IS2
Диапазон калибровки	-20,00°C до 80,00°C

Маркеры основного изображения

Имя	Температура	Коэффициент излучения	Фон
Центральная точка	42,00°C	0,95	24,00° C
Горячий	42,80°C	0,95	24,00° C
Холодный	19,31°C	0,95	24,00° C

Испытания светового модуля на поверхности с драйвером (стресс нагрузка)

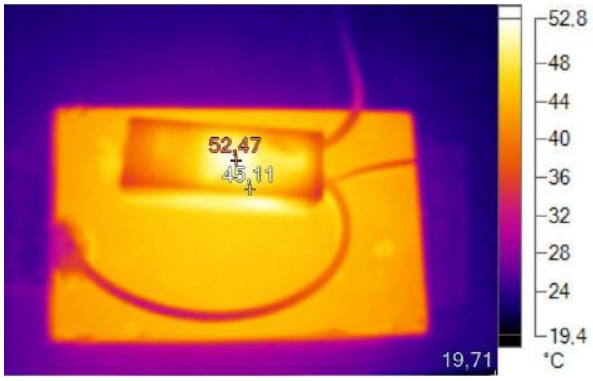

IR_00826.IS2
14.09.2019 16:22:28

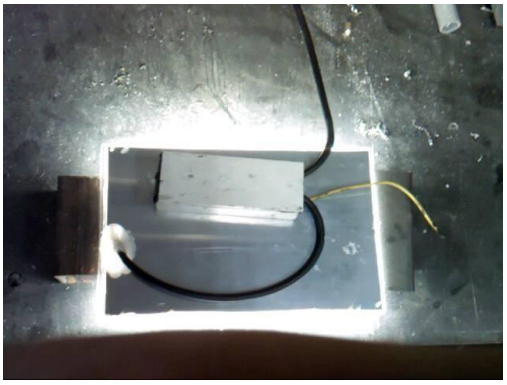

Изображение в видимом свете

Информация об изображении

Температура фона	24,00°C
Коэффициент излучения	0,95
Передача	1,00
Средняя температура	33,59°C
Границы изображения	19,71°C до 52,47°C
Модель камеры	TiS45
Размер ИК-датчика	160 x 120
Серийный номер камеры	TiS45-17010391
Версия DSP	3.10.16
Версия OCA	3.10.16
Производитель камеры	Fluke Thermography
Время изображения	14.09.2019 16:22:28
Местонахождение файла	E:\ Новая папка\ IR_00826.IS2
Диапазон калибровки	-20,00°C до 80,00°C

Маркеры основного изображения

Имя	Температура	Коэффициент излучения	Фон
Центральная точка	45,11°C	0,95	24,00° C
Горячий	52,47°C	0,95	24,00° C
Холодный	19,71°C	0,95	24,00° C

Испытания светового модуля на поверхности без драйвера

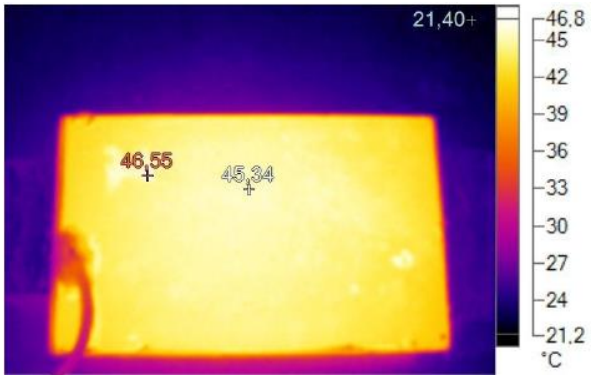

IR_00827.IS2
14.09.2019 16:23:19

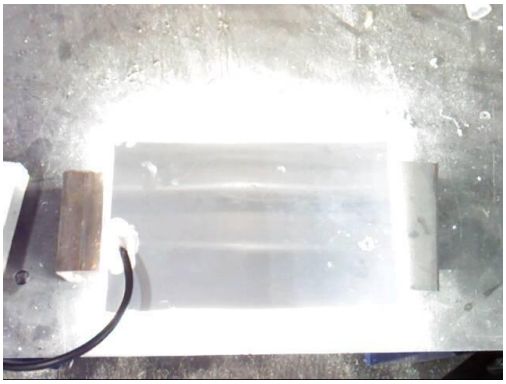

Изображение в видимом свете

Информация об изображении

Температура фона	24,00°C
Коэффициент излучения	0,95
Передача	1,00
Средняя температура	34,37°C
Границы изображения	21,40°C до 46,55°C
Модель камеры	TiS45
Размер ИК-датчика	160 x 120
Серийный номер камеры	TiS45-17010391
Версия DSP	3.10.16
Версия OCA	3.10.16
Производитель камеры	Fluke Thermography
Время изображения	14.09.2019 16:23:19
Местонахождение файла	E:\ Новая папка\ IR_00827.IS2
Диапазон калибровки	-20,00°C до 80,00°C

Маркеры основного изображения

Имя	Температура	Коэффициент излучения	Фон
Центральная точка	45,34°C	0,95	24,00° C
Горячий	46,55°C	0,95	24,00° C
Холодный	21,40°C	0,95	24,00° C